


## Kalibrierschein Nr. / calibration certificate no. 831

Hersteller (manufacturer)	E. Zoller GmbH & Co. KG
Aufnahme / Bezeichnung (tool holder / discription)	adapter SK 50 / test mandrel L = 300
Artikel-Nr. / Serien-Nr. (item-no. / serial-no.)	9100020 / S.KD.288
Kunde (customer)	Zoller India Private Ltd., Indien
Auftragsnr. (purchase no.)	0ZR96302
Messgerät / Type-Serien-Nr. (measuring machine / type serial no.)	-
Prüfmittel / Bezeichnung, Prüfmittel-Nr. (test instrument / discription, no.)	EK.M U.014 / 05M U422
Prüfplatz Spindel (measuring station spindle)	2-AM
Prüfplatz Messgerät (test station measuring machine)	-
Gültigkeit (validity)	3 Jahre (years) / 31.12.2023

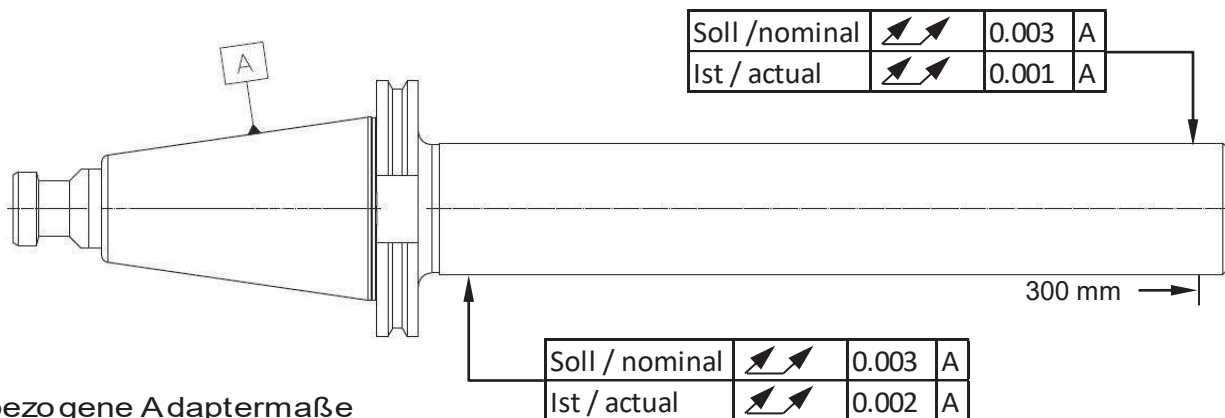

Achsbezogene Adaptermaße  
(axis-related adapter dimensions)


Z = -

X = -

Firma company	Datum date	Leitung Kalibrierung und Kontrolle head of calibration and controlling	Bearbeiter person in charge
E. Zoller GmbH & Co. KG Einstell- und Messgeräte Gottlieb-Daimler-Straße 19 D-74385 Pleidelsheim Tel.: +49 7144 8970-0 E-Mail: post@zoller.info	01.01.2021		

Dieser Kalibrierschein wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsgültig.

This calibration certificate was created by machine and is valid without signature

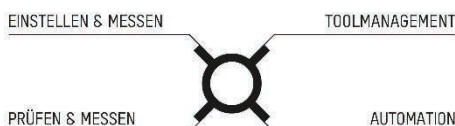

Rev. 2021-01-01 / 00 / wl  
**Technische Änderungen vorbehalten**  
 E. ZOLLER GmbH & Co. KG | Einstell- und Messgeräte  
 Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Pleidelsheim  
 Tel. +49 7144 8970-0 | Fax +49 7144 8060807  
 post@zoller.info | www.zoller.info

**ZOLLER**  
 Erfolg ist messbar